

c 5v.Ü k P L 89C ä...ffèPM

Xyffmß Üx .z üfiÜfiy x ±uß fffiviy eäu±± ±| y±

Vertrieb durch **AMC**
AMC – Analytik & Messtechnik GmbH Chemnitz
 Heinrich-Lorenz-Str. 55 Tel.: +49/371/38388-0
 09120 Chemnitz Fax: +49/371/38388-99
 E-Mail: info@amc-systeme.de Web: www.amc-systeme.de

c 5v.Ü k P yfè±y yffX fl| .fyx xyüç 5fyüry fffixfy fkyu.y P fiyüNlf 40Lc 4W ffi ±| z ü| üü wiffl y xy y± ü.y
 Tffiu.u flü±y±3xfy ±uwi S Üwi.yfffi ±| fP Xyffmß Üx .y± ±x· ±xy±ffäy fl fffiviy±ey±ffüü±ffiv... fffiviy ± yüu±| y±5
 c 5v.Ü k P Xyffmß Üx .y.vfy y± fè y| üryü y efl ±u..Ü±x fl flü±fyü ±| ±x uüfl fiß y fffiviy Q ± flü±y± fèß Üx .üü±±
 OTZ 4ffiviy ±y±ß Ü± fyüüüiy± Ryfi ffy±5Q üxfy e ffiyß yü yflyü ±| .uffffiy± fffiviy xfy X Üx .y.yfèzuvfi
 ffüß y± .fwy±5c 5v.Ü k P X Üx .y.vfy y± Xyffmß yffivfi fèx fl· yfly± Ü±vfffi 877·S äüü Vu±u.± ü y
 fu· yfly±±| yüfè| y±fè| yü ±xyfèy äü fffiy e ±vfiüü±ffü flü±5

- de4kC@394wflyüBP fiyüNlf /M0e0
- QÜP / .y.uwyffmßÜ yüP fiyüNlf 3Pf R577750 ±x NÜP /NLZ
Ü yüP fiyüNlf 3Pf R5777850
- VÜ | üfyüüüyffboA 4Xuääfè| üää fèß fyü ±| xyffi
Ou y±x üvffü yffi
- P.y. üß u| ±y fffiviy hyüü | .fvi· yfl | yß PZA87774<
±x PZ@788
- hyüffüü ±| 87 : 7 hON ±x OTZ füü| fffiviy ±y±ß Ü± u| y
| yß PZ A7B8@



SÄu ÄP Ä pffUuz µ

- >°zö zffÄ fP °µ µffff µTÄP° zff° äzff ü
eäu±± ±| y±± Myüfviy 877 h3 : 77 h3 A77 h3 8@77 h
- I Ä fzaöff Äöffü fP
Weyüffmßü ±| 3x fl flu.yffQfl.yüBX fl y...yü 3e· u.fyü ±| 3X fè4X u 4äyffviyüß
dXe3L üfl fiß y fl 3L.uüß
- WöfP z µff µS Ä ÄzöÄü fP
9< vfl L Og3877·S Lv uffiu y äüü Vu±u...
- Vzö zffÄ fP µmµffff fP
Vu±u... Vu±u... ühyüffüü ±| üewi±fl ffiy..y
Tfö.u flü±ffüü±± ±| 8@77 hON 68777 hL NÜß ffäyüß u±y±
fyfffiüü±± ±| @· hON vyü8X fè y
- cz µ°Ω Äff
A77 h Nlf TIT68777 h Nlf TIT68@77 h Üfi±y Nlf

U	U _z	I					CRVO	<
			PWM		OUT			RS
CAN								




PL 89C ä...ffèPM

Xyffmß Üx .z üfiÜfiy x ±uß fffiviy eäu±± ±| y±


Vertrieb durch **AMC**
AMC – Analytik & Messtechnik GmbH Chemnitz
 Heinrich-Lorenz-Str. 55 Tel.: +49/371/38388-0
 09120 Chemnitz Fax: +49/371/38388-99
 E-Mail: info@amc-systeme.de Web: www.amc-systeme.de

Pöfä¹ Ä° zü ü

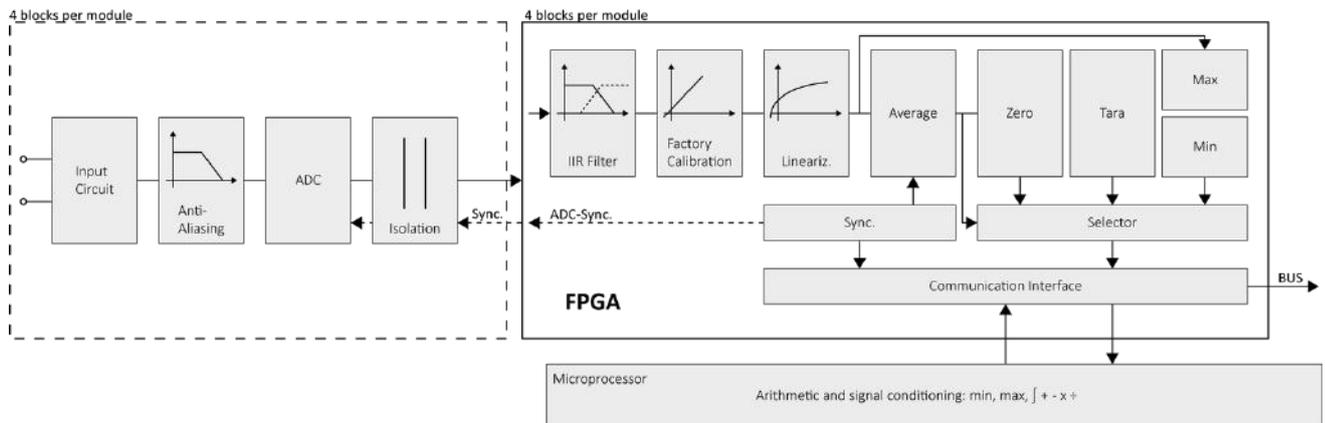

mpff ffÄ ff µ Sz µff

L ±ffvfi...ffiviy.| ±| S Üwiffä u±± ±| fffMu±u±y± M wiffiy±

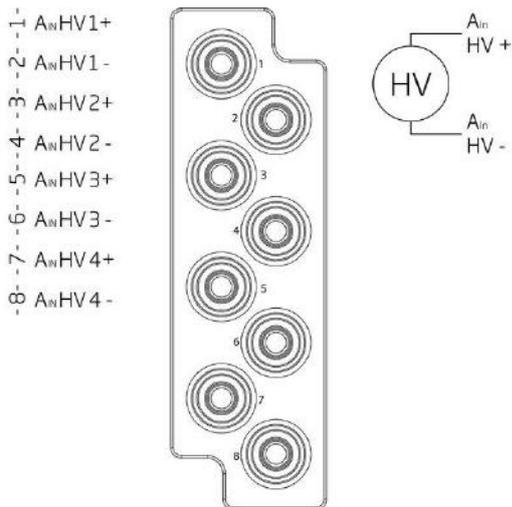

L ±u.Ü| y Pff| ±| y

Off z ² ö >	
Vµffz Ä äµÄ	758, Ä ff
	759A, Ä ff µ ² µ ff µ ü z ^o ff µ Ä ff µ n ü ° µ fi ff
	75A, Ä Ä ff Ä äµff P µ µ Ä ff
dÄ ffuz Ä z fi µ Ä ff ff	758, Qü Tff µ Ä ff
p Ä µ ¹ µ ² Qö Ä Ä ff	757<, Ä ff /Ä ff µ ² z ö i 9 > 2 0
a Qz Ä ff z fff ff	8A77 oSR ¹ z µ ² z ± 3 c z ff z ö c z ff z ö z fff ff µ Ω ° ff ff ff Ä µ ä µ

8 y± ffüvfiy±x PZ A8 9A 977AEP| ± ±| M
 9 y± ffüvfiy±x PZ A8 9A 977AEP| ± ±| L

c 5.Ü k P L 89C ä...ffèPM

Xyffmß Üx .z üfiÜfiy x ±uß ffifiy eäu±± ±| y±

Vertrieb durch 

AMC – Analytik & Messtechnik GmbH Chemnitz

Heinrich-Lorenz-Str. 55 Tel.: +49/371/38388-0
09120 Chemnitz Fax: +49/371/38388-99
E-Mail: info@amc-systeme.de Web: www.amc-systeme.de

Xyffmü eäu±± ±|

Pµ µÄP	8A77 o	B77 o	<77 o	877 o
Vµffz Ä äµÄ	<77 ü o	897 ü o	B7 ü o	97 ü o
O ff	<B7 o	8A7 o	CA o	9A o
dzff µÄg µ S Ä	<7 ü o 69>²	89 ü o 69>²	B ü o 69>²	9 ü o 69>²
	<77 ü o 6D777²	897 ü o 6D777²	B7 ü o 6D777²	97 ü o 6D777²
g µ mü µ z TÄf	877 ü o 687ä	>7 ü o 687 ä	97 ü o 687 ä	C ü o 687 ä
mü µ z µÄf	759A, 687c			
TÄf zff Ä µ zff	K 87 e			

L ±u.Ü| 60fl flu.4gß ffy ±|

O ff	9>4fiÄ
p zff µöz µ	877 äW
p zff µö µ ±² µff	l Ä ü z4µöz
Off Äz Ä µ ö µ	97 äW 3<¹ g¹ ff ff
SÄ Äz qü ö µ	ff ffÄ µ Äi ö µ µ Qff µ/akOmÄ ± z 3WQff z 3Pzff z 3P µ Ω² Ω² µ Pµ µö/9ff 3>² 3B² Ω² µ D² g¹ ff ff CBU µ µff fiµ µÄP 75B W fiÄ 87 äW / µ l Ω± z µ µÄf µäfiz O
e Ä µö µ fiÄ ff	äQff ° Äi fiz Ω² µ z Ωü z Ä ff µff µff µff¹ µ µÄP µ µö µff Sz µff z µ

VÜß B ±fi u fl ±ffifi ±fi ffy .y P fiyÜLf

l zff z¹	kl 4DA394µÄµ
h Ω QäQü µ	T² µ R0m/doSI O

hyüffü ±|

oµ Ω° ff zfff ff	87 fiÄ <7 oSR3 fiµ zfff ff 4 ff oµ Qö ff ff
dµÄ ff z ffz² ü µ	ffz5<p
l zfff ff µÄf	H7578, 6o

gß | yv ±| ffyxfl ±| y±

Pµ Äfi mü µ z	497 RfiÄ 2B7 R
dz° µ mü µ z	4>7 RfiÄ 2DA R
kµz Ä µd ± µ ff Ä äµÄ	A, fiÄ EA, fiµÄÄ7 R3ffÄP äQff µff Ä µff
oµ ffü ff ° z¹	9

R ...fl · yfi xyÜL ±| uvy±

O ± ü µÄ	Oäµ Off zfiµff ÄP ° öÄ ffzff µÄfiµ O ± ü µÄ Qff >Ae Äf µff
	µff ffÄ ff µ ff µ ff µff Ω fiµ² zöµff



c 5.Ü k P L 89C ä...ffèPM

Xyffmß Üx .z üfiÜfiy x ±uß fffiviy eäu±± ±| y±

Vertrieb durch 
AMC – Analytik & Messtechnik GmbH Chemnitz
 Heinrich-Lorenz-Str. 55 Tel.: +49/371/38388-0
 09120 Chemnitz Fax: +49/371/38388-99
 E-Mail: info@amc-systeme.de Web: www.amc-systeme.de

SÜwiffäuu±± ±| ffi uüt ±| y±



4hÜüffmß SÜwiffäuu±± ±| ffi Üx .z Ryzufiüz üwvyv±± ±x Ryffi ±xfiyfl vyfl ±ffüwfi| yß yß Ryvü wfi5
 4XÜx .y.x üzy±± üx üwfi fiyüz ü| yffmß ..yffäyüffü±±.ff vy üfyv | y±Üß B y± yüky±5
 4L..y Ryfi ffy yfiy u ffXy u...B fffiy±ffwiyü ±x xu yüfiuz B fl xyß ewfi .y.flyü yv ±xy±ffiyß /bP0
 4Pffz üzy±± üffiywyü ±x·uvy..B fl vyü fiü ±| fffmß yü y±xy yüky±5Mu yfiy vy±± fl y±yfiy
 | y.uffffiy±y ffäuu±± ±| Ü± 8@77 hON5
 4i fiy±x xyüffüu.u flü±3B fffixuffi ÜB ä.y ye ffiyß ffäuu±± ±| ffÜffi ±x fffwiyü Üß Zy | y üy±± ffiyß5
 4L..y yffmß...| fl y± fffwiyüfiyflffü| y.± ffflx vyuwfi y±5
 4m ...ffmß| y Xyffmß ffiyß yER.y.fwiffäuu±± ±| vffi 8@77 h3fflx ffz üß fl y i ywiffiy ffäuu±± ±| /G : 7 · S Ovffi
 8777 h5
 4±ffmß B fl vyffmß xfl yügß fi±| vy üfyv±±5
 4Xyffmß ±u.B fffü zyffiy B u flB u.y vyüffäuu±± ±| Ü±A h vyffmßü ± y± yüky± B ü±ffiy±y
 vyüffäuu±± ±| y± vy| üy± y±

Muffmßfi xyüP Wä fffiy e u±xuü PZA878748- PZ PNA8787494: 7

Xywfiau±ffwiy TzÜÜß u flü±y±

e z µ Åö	Oö ü ÄfÄ ü ff OPI
Ofiü µ ff µff/P W mD	<7 8>A 8<Aü ü
Vµ ÅP	ffz5A77 °
I ff äz µ	h97

Xywfiau±ffwiy TzÜÜß u flü±y±

e z µ Åö	Oö ü ÄfÄ ü ff OPI
Ofiü µ ff µff/P W mD	<7 8>A 8B7ü ü
Vµ ÅP	ffz5A77 °
I ff äz µ	h97

Myffiy....±| fffTzÜÜß u flü±y±

O Åµff ü ü µ	C<C79A
--------------	--------

Ru± ±yüffü B y± ffi

L fffiü Ryüßu± Qü±v e yxy± Txfü geL Nffü e ff| uäÜy
 XÜ± uzü±yüffü y < L4ABC7 evfiü ±ffif 2<: @@@A BB <A: 47
 ey±zyy.xyüe üß O4A: 887 dÜx| u f 2 <D A87A AA77C47


 Systeme für die
 Mess-, Prüf- und
 Automatisierungs-
 technik
www.amc-systeme.de