

h6 oc P: @ @ cTdf @gF

l ü- y fl B d- ä- y Bö ö- g - ü

Vertrieb durch **AMC**
AMC – Analytik & Messtechnik GmbH Chemnitz
 Heinrich-Lorenz-Str. 55 Tel.: +49/371/38388-0
 09120 Chemnitz Fax: +49/371/38388-99
 E-Mail: info@amc-systeme.de Web: www.amc-systeme.de


h6 oc fly - - düäüflfl- h6- ü o ü flü üfl-y- SPh5c äß ä |ölä- fl- - y -
 X y y ü - 4flü -ü ä Bö lä- - d- fl - fl y ä-ß lä- j- y |ö - z- lä- 6üü
 fl y - 45X5 |öü - ü zy - V-ö - fl- h6 oc5g fl ffi- y - üö-üß|ö
 y - -|ffä fl- y z- -ü- |ö - j - - -ü- ä6ü - ü- 4fl- - y -m- -ü ä
 - y z flü ü- fl |ö üü - Sy - -ßy ä yö-y ff -üä- d- ffi6 - - j- 5byz-
 Bö - -ü- ä-üä- - j y B läffü6

- ijBFCU- flz 5 |ö ü - -zü BFdz Ht |yQ 4 ■ T-ffi yä - ü|ö-m- ä üöffiüä- TeD: 8885B
 zü :: C@ffz Ht flz 5 kl 4pjRX flTeCC8: :
- P |öü zy y y -R - h6 y ü o ■ j y ä - ä ä : 86A8 mSR
- d yä-y Bk yä |öü - ÖTeD8E: C1



Rfl 2± µ flö Tflx fl

- i z±öflüü ±üz±x flöfffl Rµ° xÜ fl öµ
 @Bzü PSI 4 88 ffW Pz y y - by y
- ax flµü flö
 : 888 mRPk X fl D88 mRPk X
- 9 µxÜxö° z±µfl flöö fl ö° fl flüü S°µxöµ Äxö üü
 n üfl- y fl@ fl B5c-ü- 4g : 884g : 8884X y ü : @88 mSR
 - y -
- i µxÜüüöff° üöfl öµ
 cü -y üü ä4fläüy - Uü - 4d ü - - 4j ffy ü ä4
 d ü 57d y 5 -üö- 4T - ffiü - 4P üö - üffP y
- UxÜxö° z±flk flöö öµ
 by y by y m- ä ä j |ö ü - -4
 X y ü y ä : @88 mSR 7FBF nPR
 g B y ä C ffirSR z- : ü

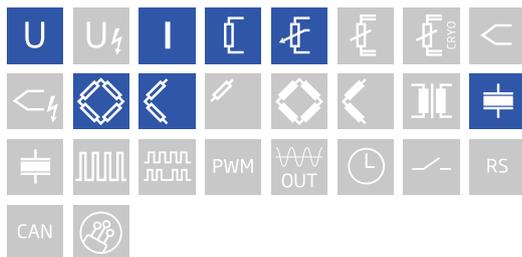


Systeme für die Mess-, Prüf- und Automatisierungstechnik

h6 oc P: @ @ cTdf @gF

l ü- y fl B d- ä- y Bö ö- g - ü

Vertrieb durch **AMC**
AMC – Analytik & Messtechnik GmbH Chemnitz
 Heinrich-Lorenz-Str. 55 Tel.: +49/371/38388-0
 09120 Chemnitz Fax: +49/371/38388-99
 E-Mail: info@amc-systeme.de Web: www.amc-systeme.de



0üZÄfi'xµ xä ä

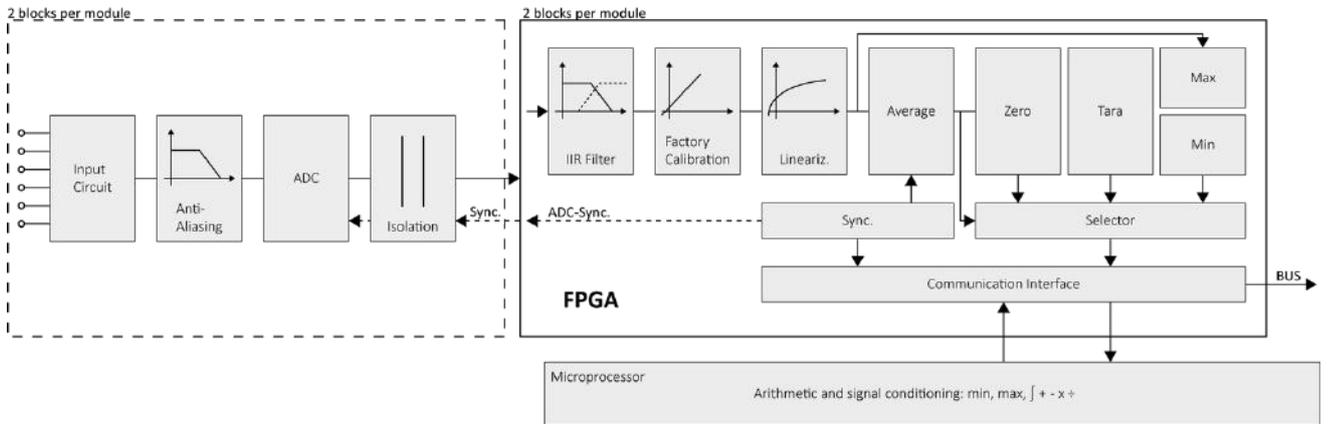

kflz±ö° z±fl Rx flö

P |ö z- -ä ä cTdf @gFg

- 1 -
- 2 -
- 3 UF
- 4 A_{in} 1
- 5 A_{in} 2
- 6 A_{in} 3
- 7 A_{in} 4
- 8 GND

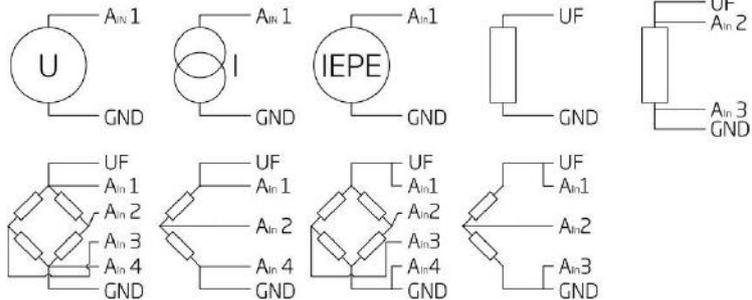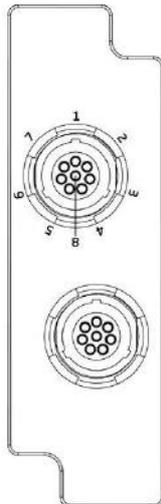

j -|ffä HtDf RbR6VBF6ccVk RR flü ä

P y ä- Tü ä ä-

Nö x±Ü	9
Ufiöx µÄfi°	758, Ω° z±
	759A, 6 yfl±fl z± fl ä xµöfl ° z±fl l ä µfly öm
	75A, 6 6fi 9lÜüö Ofi flz±
b6flx ° xy flz± öµ	758, üä Söfi fl Ω° z±
n 9lfi fl ±üÜ ° 6üö	757<, Ω° z±/6öfl ±xÜ 9> ±0
WüÜ 6üö Ωxöö öµ	8977 mRP fix fl ±x ¹ 3axöxÜ axöxÜ i Ωxöö öµ fl ü µ öm i z±ö° flÜü

: - -|ö- fl Te D: A@d @8BDHT ä ä Q
 @ - -|ö- fl Te D: A@d @8BDHT ä ä P



h6 oc P: @ @ cTdf @gF

l ü- y fl B d- ä- y Bö ö- g - ü

d- y j y ä

Vertrieb durch 
AMC – Analytik & Messtechnik GmbH Chemnitz
 Heinrich-Lorenz-Str. 55 Tel.: +49/371/38388-0
 09120 Chemnitz Fax: +49/371/38388-99
 E-Mail: info@amc-systeme.de Web: www.amc-systeme.de

	Ofi fl ^z ±	ä x 5Ny fl ^z ± öμ	N öμ
Ny fl ^z ± öμ	87 m	9 ä m	859 m
	8 m	73 ä m	897 öm
	877 ä m	97 m	89 öm
Söμxöμ fifl xöfi	K87 c		
bxöμ fl ^o fi °	H97 m69> ±	H977 m6D777 ±	
kflä Ωfl x fl ^o	N ¹ d ÜÖ öÄ	N ¹ c fl flä Ω öfiÜz±Äfl°	
	HA7 m687 a	H759, 687 a	
i μöxÜx z±4 fl ± Üö°	K877 fi0yfl°877 V		

d- y j

	Ofi fl ^z ±	ä x 5Ny fl ^z ± öμ	N öμ
Ny fl ^z ± öμ % fl öfi i ± ö A7	9A ä N	A N	<5 öN
bxöμ fl ^o fi °	H75A N69> ±	HA N6D777 ±	
kflä Ωfl x fl ^o	N ¹ d ÜÖ öÄ	N ¹ c fl flä Ω öfiÜz±Äfl°	
	HB N687 a	H759A, 687 a	

d- y n üfl- y fl7i kS

	Ofi fl ^z ±	ä x 5Ny fl ^z ± öμ	N öμ
Ny fl ^z ± öμ	877 Ä	877	89 ä
n fifl xöfi394öfi>4fl° fl	> Ä	8	75A ä
n fifl xöfi394 öfi>4fl° fl	>77	75B	>D
f 877394 öfi>4fl° fl	4977 y° 2DA7 P	759A P	759 ä P
f 8777394 öfi>4fl° fl	4977 y° 2DA7 P	8 P	759 ä P
bxöμ fl ^o fi °	H758 P69> ±	H75B P6D777 ±	
kflä Ωfl x fl ^o	N ¹ d ÜÖ öÄ /Ofi fl ^z ±>77 0	N ¹ c fl flä Ω öfiÜz±Äfl°	
	H87 ä 687 a	H759A, 687 a	

d- y g - ü - -

q Ü μfl f ü flö üä fl fl fifl xöfi	8Ä y° 87 Ä		
bxöμ fl ^o fi °	H758, 69> ±	H75B, 6D777 ±	
kflä Ωfl x fl ^o	N ¹ d ÜÖ öÄ	N ¹ c fl flä Ω öfiÜz±Äfl°	
	H75778687 a	H759, 687 a	



h6 oc P: @ @ cTdf @gF

l ü- y fl B d- ä- y Bö ö- g - ü

d- y Q |ff

Vertrieb durch 
AMC – Analytik & Messtechnik GmbH Chemnitz
 Heinrich-Lorenz-Str. 55 Tel.: +49/371/38388-0
 09120 Chemnitz Fax: +49/371/38388-99
 E-Mail: info@amc-systeme.de Web: www.amc-systeme.de

O zÄflöx	müÜÜ öfiVxlyy zÄfl3A4B4bfl° fl	
Uflöx 9uÄfl° ÄÜx fl	75A	
N 1öfl±ä fl °ffl xöfi	K877	
O zÄflö fl° öµ	95AmRP3öüä °xÜ	
c fl yfl flz±fl	95ä m6mB Aä m6mB 87 ä m6mB 9Aä m6mB A77 ä m6m	
bxöµ fl° fi °	H759 m6m69> ±	H89 m6m6D777 ±
kflä fl x fl°	N 1d ÜÜ öÄ	N 1c fl flä fl öfiÜz±Äfl°
	H79 m6m687 a	H75A, 687 a

d- y XgT

Ny flz± öµ	Ofi flz±	ä x 5Ny flz± öµ	N öµ
	87 m	87 ä m	859 m
	8m	8ä m	897 öm
mfl ü µ öµ	aüö xö üä > ä N		
S°µxöµ 1 flö flö yfl flz±	79AV y° 87 ÄV		
kflä fl x fl°	N 1d ÜÜ öÄ /Ofi flz±87 mD	N 1c fl flä fl öfiÜz±Äfl°	
	H87 m687 a	H759A, 687 a	

P y ä7Säüyl - ä

N öµ	9>4°		
n xöffflÜx fl	877 ÄV /yfl°c fl x k±fl ä üflÜä flö fl DV 0		
n xöffflÜfl 1x± flö	i 9ä x4flÜx		
Nö °xÜx °µ Üfl	97 ÄV 3< fl e flö öµ		
R9µ xÜfl Üfl	W ö fl ° fl Üfl fl Üö fl /WÜÜk °fl°Qx 3Vüz±Qx 30xöfiQx 30 fl ü ± üfffl Ofi flÜ9öfi3> ±3B ± üfffl D ± e flö öµBT flö flö yfl flz±75BV y° 87 ÄV /fl i ü1 x fl fl° flÜx 0		
c° flÜ fl y°Ü öµ	Äüö µ °fl yx üfffl x üä x ° z±flö flz±flöfi flfl fl°µfl flÜflö Rx flö x fl		

R üy ü X - B| - c |yz

f ü üÄüÜfl	f üö fl fl büzxÜÜ /88A977 yQ y° >Dc yQ 3bx flö H877 ö 0 Ni Pw8E977 yQ y° 88A977 yQ 0 c üffy hkl		
Rx flö1ü ä x	DSB		
i xöfix fl	Ndi Wk W6SW4 DA4N394 ° fl		

m- ä ä

mfl ü µ öµ Qxöö öµ	87 y° <7 mRP3 yfl Qxöö öµ 4 öfi mfl QüÜ öµ z±		
bfl° öµ x 1öx±ä fl	zx59 n		
i Qxöö öµ fl°	H7578, 6m		



h6 oc P: @ @ cTdf @gF

l ü- y fl ß d- ä- y Bö ö- g - ü

l ä-z ä z-flü ä ä-

Ofi fly flä Qfl x	497 Py° 2B7 P
bxµfl flä Qfl x	47 Py° 2DA P
hflü ° fl b 1 fl z± µÄfl°	A, y° EA, yfl°A7 P36z± Äüöffl° fl flöfi
nfl z±ä öµ µ xfi	8

V äffü fl- P äyz-

N 1 ä fl°	NÜNöµxyfl° °flµ Üµöxz± fl°fl N 1 ä fl° üö >Ac ° flö
	kflz±ö° z±fl öffl öµflö ü yfl±xÜflö

W |ö y ä ny ä-



5m üö!W |ö y ä fl !5V-ßyö ß c-z- flV- flö-ü z-ü y|öä- - V-z y |ö6
 5d fl -fl ß fl |ööü ß ä- |ö - g- y ü Q- üz ä- - - fl- 6
 5P -V-ö - -ü-y d-y - üö- flfly - öyß üfl- j|ö -ü- QgT1 - z fl- -ü6
 5T fl ß j -|ffl flbyz- üQ- ö ä |ö - - fl- - fl- 6Qy -ü- z- lä- -ü-
 ä-y - -j y ä :@88 nSR6
 5n ö - flfl- X y y ü fly ffi - -j - y ä -ü fl üö- e- ä- -
 - fl- 6
 5P --ü |ö ää- jüö- ö-ü -ä- üfl z-y|ö - 6
 5eüö üz- |ö flä - l ö äz- -üz- 6

Qy ü ü fl- T ü|ö-j y fly flTeD: 8: 85

d-löy ü|ö-XB y ü -

c x fl %Ü	NÜä °° ä öfiNOi
Nyä fl öµflö/O V kO	<7 8>A 8B7ä ä
Ufl z±	zx5A77 µ
i z± Äü fl	W97

Q- - üß y ü -

N %flö ä ä fl	CCD9<9
---------------	--------

Vy - X -

P üy V- y Uy |- j -fl- Xflü l j P Röü y jü äy -

Vertrieb durch

AMC – Analytik & Messtechnik GmbH Chemnitz

Heinrich-Lorenz-Str. 55 Tel.: +49/371/38388-0
 09120 Chemnitz Fax: +49/371/38388-99
 E-Mail: info@amc-systeme.de Web: www.amc-systeme.de