

# e5wÜ I Z M89C ffÜ gRN

az ä üy Ü -ü-z y övä · x-z gffvöö öflzö

e5wÜ I Z yv öz za · flüzyz e5z ·zl · yz ·yzvü QMe4Z öfl| flü x-·flz yz zö vü  
 Vö vÜ ·üözö3y·z ü · öfl | -·flz zöaz ä üy ü öyäv flz|z ·flz gzö ü vö x-Ü z wö ·flzö5Q·z  
 ä üy ü zö3QV4gx-·zözö ä üö ·z w zö Tz- z yz e5wÜ I Z4d üy ±z ü zö ·x- z-ö|vx-  
 vä ä zö zx±zö öyz ü wö üz·öz x-özÜg zäz z ·z öfl5Q·z z ·wü3yz zö vüjz z ·Üöfl  
 z ü w y·z ffi ·z öy öx- üö ·z z Qv zöz |v öflöv-z vä ü z ·flzöaz ffi ö±5X z z gzö ü 4xvwzÜ  
 | - zö z ·öz flz ·öflz zög vöj Üfl±z 5

- fg<C@Szÿw 4gx-ö · zÜ w <C a wffiEZüvÜW 3 ■ Rü± üä vflöz · x-z jz flük-±z flzä Rb A87774<  
w 88@9 ±wffiEa üyw 4f hi 3MgPW öy Rb @@788
- Mö x-ü z w vö vÜ Püö üÜ e5 v ·üö! ■ gffvöö öfl z ü fl öfl 87 5 7 j QP
- a üö vflz v | h vfl x-·zöz /Rb A7B8@0





## R² ¶² ±¹ ü T¹y ¹

- > ±yä yü² ff ±¹ ¹üü ¹ S±ü±yü± Üyü ¶  
gffvöö öflzö3Nz z·x-z 877 j 3 : 77 j 3 A77 j 3 8@77 j
- k²±üyüüffüff² ¶ffü² ü±  
Zözv ·z öfl3y·fl vü S·Üz 3a · zÜ z 3g±vü öfl3a ·ö46a v 4gffz·x-z 3  
f a g3M · -ä z ·±MÜ ä
- Vffff y ¹ ü fl¹ R²±² y¶² ü±  
9< w MQi 3877 ±U M wv v z ffiü XvövÜ
- Uyä yü² ff¹ | ¹üü ü±  
XvövÜ XvövÜ jz ü fl öfl gx-ö · zÜ  
Vüü ·üö ffvöö öfl 8@77 j QP 8777 j MP ä ffz ä vözö  
hz ffvöö öfl @±j QP wz 8a ·ö z
- by ¹ ±ff² ü  
A77 j P Mh W68777 j P Mh W68@77 j ü-öz P Mh

Vertrieb durch **AMC**

**AMC – Analytik & Messtechnik GmbH Chemnitz**


Heinrich-Lorenz-Str. 55 Tel.: +49/371/38388-0  
 09120 Chemnitz Fax: +49/371/38388-99  
 E-Mail: info@amc-systeme.de Web: www.amc-systeme.de

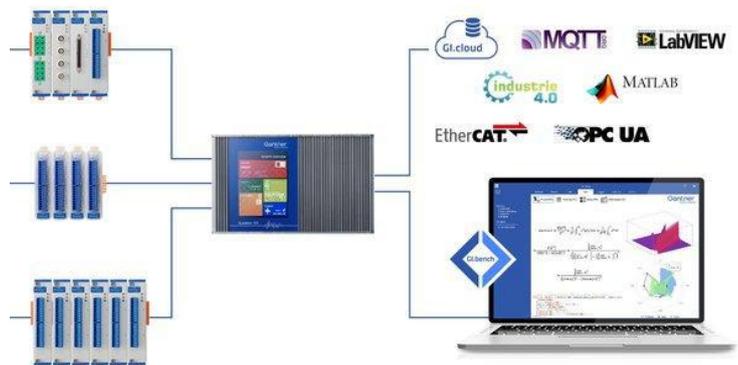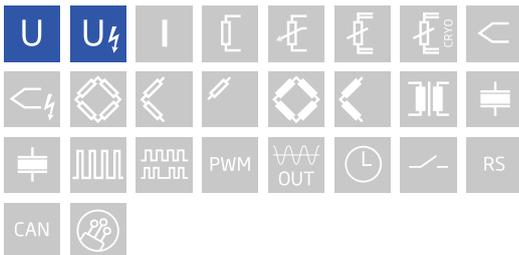

# 500 I Z M89C ffÜ gRN


az ä üy Ü -ü-z y övä · x-z gffvöö öflzö

## ÖffflÜflz± yö ö

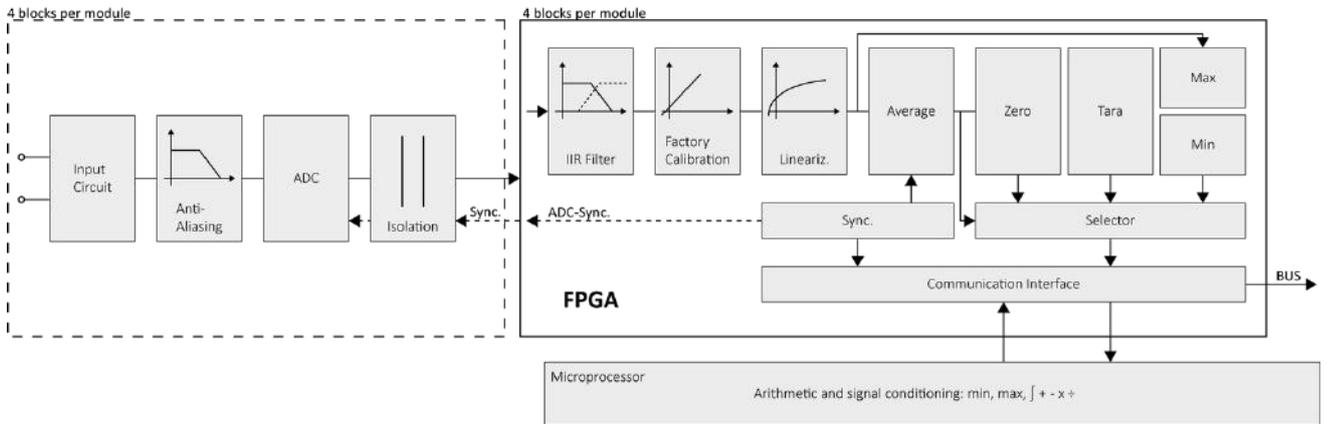

## I 1 ff° ü² ff¹ Ry 1 ü

Mö x-Ü wäzfl öflUüx- ffvöö öfl Nvövözö N x- zö

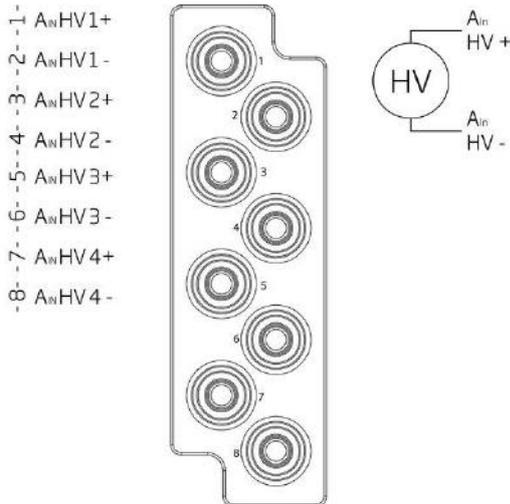

## Mövüflz Röfl öflz

Nü y° ä >	
U¹ üy z±Ü²	758, Ω² ff
	759A, üz¹°¹ ff¹ ö y±ü¹ z ff¹ mö ±¹z ü±
	75A, zö üfl z ä ü O¹ ¹ ff
cü¹y² yz ¹ ff ü±	758, ffö Süfl ¹ Ω² ff
o z fl¹ ° ffΩ z ffü	757<, Ω² ff /üü¹ °yž 9>°0
Wffäy ffü Öyüü ü±	8A77 nRP fly ¹ °yµ zbyüyä byüyä kÖyüü ü± ¹ ff ± ü± kff ü² ¹ ä

8 zö ffizx-zöy Rb A8 9A 977AER fl ö öfl N  
9 zö ffizx-zöy Rb A8 9A 977AER fl ö öfl M

# e5wü | Z M89C ffÜ gRN

az ä üy Ü -ü-z y övä · x-z gffvöö öflzö

az v gffvöö öfl

O <sup>1</sup> 1ff	8A77 n	B77 n	<77 n	877 n
U <sup>1</sup> üy 2±Ü <sup>1</sup> 2	<77 ö n	897 ö n	B7 ö n	97 ö n
N ü±	<B7 n	8A7 n	CA n	9A n
cyü± 12 f 1 R 3µ	<7 ö n 69>°	89 ö n 69>°	B ö n 69>°	9 ö n 69>°
	<77 ö n 6D777°	897 ö n 6D777°	B7 ö n 6D777°	97 ö n 6D777°
f 1 l <sup>1</sup> ö Q <sup>1</sup> y S3ü	877 ö n 687Ü	>7 ö n 687 Ü	97 ö n 687 Ü	C ö n 687 Ü
l <sup>1</sup> ö Q <sup>1</sup> y 13ü	759A, 687b			
S3ü±yü± 3µ yüfl	K 87 d			

MövüflEQ·fl· vÜ ä z öfl

N ü±	9>4 <sup>2</sup>
o yüfl <sup>1</sup> äy 1	877 ÜV
o yüfl <sup>1</sup> ä <sup>1</sup> µ <sup>o</sup> 1ü	k <sup>2</sup> ±ö y4R <sup>1</sup> äy
Nü 3y3y 3ü± ä <sup>1</sup>	97 ÜV 3< flf flü ü±
R <sup>2</sup> ±2 yä ä <sup>1</sup>	W ü <sup>2</sup> 1 3ö Q ä <sup>1</sup> 1 Qffü 1 /WVÜ <sup>1</sup> 2 µQy 3VffffQy 3OyüflQy 3O 1 ff ° fff <sup>1</sup> O <sup>1</sup> 1 ä/9üfl3> ° 3B ° fff <sup>1</sup> D ° f flü ü±ÜT <sup>1</sup> 1 ü z <sup>1</sup> 1 3µ 75BV z <sup>2</sup> 87 ÜV /Q <sup>1</sup> kffµ y 1 1 3ü 1 äzy O
d <sup>2</sup> 1 ä <sup>1</sup> z 3fl ü±	Üffü ± 2 zy fff <sup>1</sup> y ffö y 2 ff <sup>1</sup> ü Q <sup>1</sup> ff <sup>1</sup> üfl fl <sup>1</sup> 1 3ü± 1 3ä <sup>1</sup> ü Ry 1 ü y 1

Xüä ä ö·±v ·üö x-ö· zÜÜ ZüxvÜÜ

g ff flÜff3	g ffQ <sup>2</sup> 1 cffiy3D /88A977 zQ z <sup>2</sup> >D d zQ 3cy 1 ü H877 ü 0 NkPW8E977 zQ z <sup>2</sup> 88A977 zQ 0 d ffflz i l m
Ry 1 üff ö y	DS8
k yüfly fl	NekW W6SW4>DA4N394 2 <sup>1</sup>

j z ü fl öfl

n <sup>1</sup> ff ± ü± Qyüü ü±	87 z <sup>2</sup> <7 nRP3 z <sup>1</sup> Qyüü ü± 4 üfl n <sup>1</sup> Qffä ü± ff
c <sup>1</sup> 2 ü± y µy <sup>o</sup> ö <sup>1</sup>	fy5<o
kQyüü ü± 1 3ü	H7578, 6n

i ä flzw öfl wzy·öfl öflzö

O <sup>1</sup> 2z 1ö Q <sup>1</sup> y	497 Pz <sup>2</sup> 2B7 P
cy± <sup>1</sup> 1ö Q <sup>1</sup> y	4>7 Pz <sup>2</sup> 2DA P
i 1 äy 2 <sup>1</sup> c µµ <sup>1</sup> ff 2±Ü <sup>1</sup> 2	A, z <sup>2</sup> EA, z <sup>1</sup> 2A7 P3ü3µ Üffüfl <sup>1</sup> ü 2 <sup>1</sup> üfl
n <sup>1</sup> ff ö ü± ± yfl	9

T Ü·fl±· yz Möflvwzö

N µ ö 12	N3ff Nü±yz <sup>1</sup> ü 3üfl ± ä <sup>2</sup> ±üff <sup>1</sup> 1 3ü <sup>1</sup> N µ ö 12 ffü >Ad 3ü 1 ü l 1 ff ü <sup>2</sup> ff <sup>1</sup> üfl <sup>1</sup> ü± <sup>1</sup> ü ff z <sup>1</sup> ö yä <sup>1</sup> ü
----------	---

# e5wÜ | Z M89C ffÜ gRN

az ä üy Ü -ü-z y övä · x-z gffvöö öflzö

Uüx- ffvöö öfl k v ö öflzö



4j ü ·x- Uüx- ffvöö öfl ä üy ÜTz|v- | Zzwö öyTz öy-z· wz· ö vx-flzä zä Tzww x-5  
 4a üy Üy |zö ö y x- -z | flz x- Üz ffz üövÜö wz ·zwflzöüä ä zö z yzö5  
 4MÜ Tz- z z·Ü v az vÜÄ zö ·x-z öy yv z -v| ä · yzä gx- Ü· z z w öyzö z·ö /dR0  
 4R | |zö ö z x±z öy ±vwÜä · wz - öfl x- z zöyz z yzö5Nv z·Ü wzö ö ·flzö z·öz  
 flzÜ zöz ffvöö öfl üö 8@77j QP5  
 4k - zöy yz ·ö vÜ ·üöZä yv ±üä ffz z g zä ffvöö öfl Ü öy ·x-z üä bz flz zö ö z·ö5  
 4MÜ z·ö x-Üfl·flzö ·x-z -z· zflzÜ ·öy wvx- zö5  
 4n Ü üflz az zä zETÜ·x- ffvöö öflw 8@77j 3 ·ö | ä ·flz k z x- zÜffvöö öfl /G : 7 ±U 0w  
 8777j 5  
 4ö·x- ä · wz x- y·fl z i ä - Üöflw z·wzö5  
 4az ·flövÜä v |z·öz ä v ·ä vÜ wz ffvöö öfl üö A± wz x- ö±zö z yzö ä vö ·zö z  
 wz ffvöö öflzö wfl zö zö

Nv · · yz R üffi · x-z g vöy y Rb A87874B- Rb VPA87874947: 7

## a z x-vö · x-z V|ü ä v ·üözö

d y <sup>1</sup> ä	Nä ö ü <sup>2</sup> ö üflNOK
Nzö <sup>1</sup> ü± <sup>1</sup> ü/O V I O	<7 8>A 8B7ö ö
U <sup>1</sup> ¶P	fy5A77 ±
kff Üy <sup>1</sup>	W97

## Nz zÜöfl V|ü ä v ·üözö

N ¶ü ä ö ö <sup>1</sup>	C9>D9E
-------------------------	--------

## Tvö öz V ä zö

M · v Tz ä vö Svöxz g zyzö Vöy v i gM P-öv g·öflvffü z  
 a üö v|üöz v z < MABC7 gx- ö h 2 <: @@@A BB <A: 47  
 gzö z|zÜz g 5B Q4A: 8B7 f üyflv h 2 <D A87A AA77C47

Vertrieb durch

**AMC – Analytik & Messtechnik GmbH Chemnitz**

Heinrich-Lorenz-Str. 55 Tel.: +49/371/38388-0  
 09120 Chemnitz Fax: +49/371/38388-99  
 E-Mail: info@amc-systeme.de Web: www.amc-systeme.de

