

# f Gantner ma R98Dhk

R-fi-väz bz öffy ä

Vertrieb durch **AAC**  
**AMC – Analytik & Messtechnik GmbH Chemnitz**  
 Heinrich-Lorenz-Str. 55 Tel.: +49/371/38388-0  
 09120 Chemnitz Fax: +49/371/38388-99  
 E-Mail: info@amc-systeme.de Web: www.amc-systeme.de


f Gantner ma yv üz z b-fläz yz f 6z z m - yz yzvz ROf 5a üfi | fi ff xfl-fiz yz zü v z  
 W v z ffüzü 4y-z ä- üfi | fl-fiz zü bz öffy ä üy ö v fiz | z fi z h zü ff vü xflä z w zü fiz ü R-z  
 ö ffy äv zü 4RW 5hxfl-zü zü ö ffü -z w zü Uzfl z yz f Gantner ma 5e ffy B z äv zü -xfl z-ü | vxfl  
 vö ö zü z xßz ü üy z äv w zü ffz-üz xflüz äz h z ö z z-ü fi R-z z -w z 4y z zü v z k z z-ä üfi  
 z äv w y z ffi -z üy üxfl ffü -z z Rv züz | v üfi üvflz vö z z-ä fiz zü bz ffi üß 6 z z h zü ff 5Zv w z ä  
 | fl zü z-üz fiz-ü fiz zü h vü | äffiz-6

- ghAEB Tz äw 5hxflü- z äz w- AE b wffi Gaffxv P 4 ■ S zß ffö vfiüz - xflz k z fi äxflßz- fiz ö Sc C98885A  
 w- 99B6 B wffi Gb ffy w 5gi j 40hQW/ üy Sc BB899
- Oü xfl z w vü v z äz Qffü ff z f 6 v ffü m ■ h ffvüü üfi z ffi fi üfi 98 66@8 k RQ  
 ■ b ffü vfiz v | i vfi xfl-z z z Sc C8D9B1



## O z xfl fi z ö Qz u z

- 9v ± 0.1% fl z v u z x fl z u z P z fl ö flz  
 Zvü v v fl ä- v w fi fi ffü yz Z ffü fi v ffü 4T z zü 4o fl z 4el b 4  
 h v 4 üfi z zü zy ffy z y- z zü -z ä
- P z z W u z f w p z W z z z 9 > @ f fiz ö  
 R- z zü z-üfi üfiz-ö Pz z-xfl ffü 5 8k w- 3 : 8k 4  
 h-üfi z 5 S üy z y S-üfi üfiz-ö Pz z-xfl 8k w- 3 : C k
- fz ö ü i z ü fl ö fl ff ü Vu ö u Ü
- Q z Ω z ö z z fl ö flz  
 Tz zü ö z üfi w- 9b V Q fl ffü ff bz fl ffy z 14R z fl -xfl üfi z B z üü üfi
- f u P z fl ö flz  
 S-ü z ä w z hxfl z ä z z z
- n µ z  
 k ff 5g xß fl z 4f v y v fl z ö - g z | z zü ü ä z B z üü üfi 4  
 w- 9b V
- ck Z P z fl ö flz  
 bz üfi ffü i v z fl äü- üy Tz zü 40 fiv w z ö - v -v w z  
 Tz zü üy 7 ffy z i v z fl äü-
- Ru Ü ö ± w p z g z ö ö ö fl  
 Z z ö ö z 9 Z z ö ö z : k z ffi fi üfi hxflü- z ä z


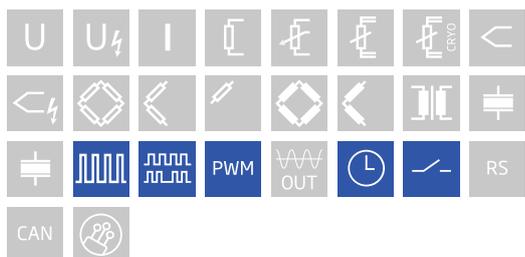


R-fi-väz bz öffy ä

gzvµ±vµz Ou zö

Oü xflä wäzfi üfiaSb d : P Eeffä

- 1 SV1+
- 2 SV GND
- 3 D<sub>in</sub> 1+
- 4 D<sub>in</sub> 1-
- 5 D<sub>in</sub> 2+
- 6 D<sub>in</sub> 2-
- 7 D<sub>in</sub> 3+
- 8 D<sub>in</sub> 3-

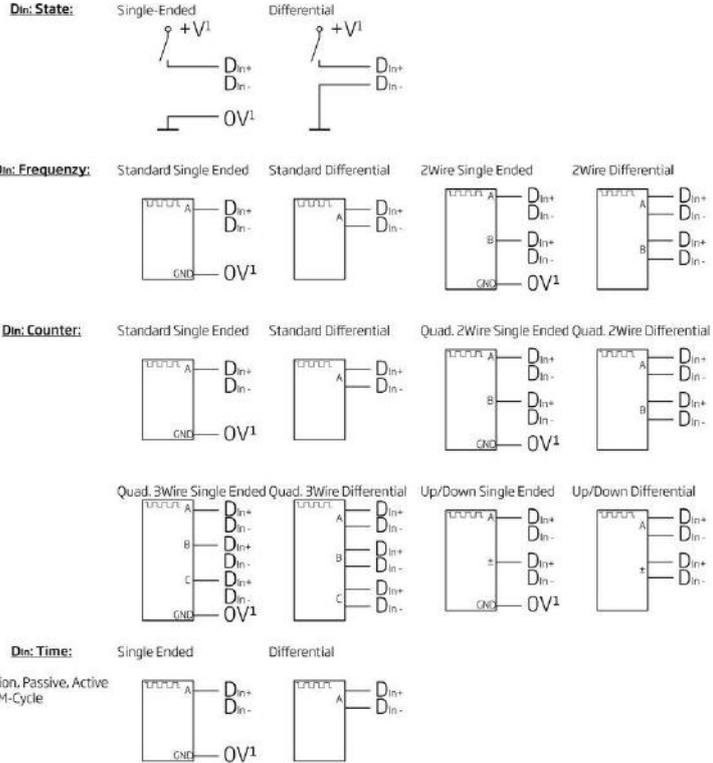

hzü ff ffz- üfi

Lö uµÜ	</ö±µ flüüö±vµ TüÜz 0
ffüö öfl	: 5 i v± 9< i /Zu 5i f 4: i 0
	Rzöu flÄz±D : , K 877 ä L
	L öflD87 ä i
f üä vzfl zö öfl	>7 ä Lv± 9>7 ä L
	Rzöu flÄz±D > ,
	L öflD877 L
wü zflzÜ öfl	F : , K : 5 i v± 89i F 8, K 89i v± 9<i
eu vµzö	F >äi /eZf 0

R-fi-väz S-üfi üfiz

Lö uµÜ	9v± @flüüö±vµ TüÜz P±fl öflz3Äüö fl ±vu uÜ x±z zö ±Üwz ±flz 4öxx	
P±fluöfl ffüö öfl	ä u 5: 7 i ON	
P±fluöfl ±z uöx	x±z zö ±Ü 97 Ä	±flz 4öxx 87 Ä
f vµÜ vµ zÜz z± zÜu ±9>@f vµ ±zö	47 i v± 297 i	7 i v± 29@i
f vµÜ vµ zÜz Rzöu flÄz±	8,	
TüÜz ±ö ffüö öfl	>77 i ONP±fluöfl 8v± P±fluöfl 9v± i z ü fl öfl ffüö öfl öxv± f vµ± zÜz	

R-fi-väz bz öffy ä

## T üß ffü R-fi-väz S-üfi üfiz

f u	
Lö ffz wµ z±	87
Q zΩ zö ä z öfl	
Z z µüxz	Nµ üöü b ff .h ± öflx wµ Vüä v.ßu tiö üö nz±ä z öfl öx B ff Ü µÜ öfl B O zµ ±wµ öfl z Äzöö öfl/7 67 0
Q zΩ zö vz z±wµ	75S v± 8ZS
nz±vu ±	7578 v± 87
ezfz zö fizΩ zö	9BB ZS
Rzöu flÄz±	7578, vz±nz±vu ± H8ä /497 Nv± 2@7 NO
Q zΩ zö ä z öflä ± O zµ ±wµ öfl z Äzöö öfl	ffz ± Äu tiö ± z±ßfuvµz Q zΩ zö ä z öfl 3Q x± e±wµ öfl z Äzöö öfl ±x x± cµu zö üflz xz vz±zö P±ßfl öflz µz uöflz üflzö
n µü	
n µü ±fz	: 94v± / : 84v±0
n µü fizΩ zö	ä u 8ZS
i ü 45 wÄ µü	Z±z±zä Üwµzö P±ßfluöfl fi x± n µÜ±wµ öfl
d ux u µü	Z±z±zä Üwµzö P±ßfluöfl fi x± e±wµ öfl z Äzöö öflä ±S±ß xz cµu zö üflz
d ux u µü ä ±ezfz zö ö W öx ez z Pöuvü	k ±xz d ux u µü uvz ä ± z± Üwµzö P±ßfl öflzö fi x± 74ezfz zö 4P Äzöö öfl öx LÄ ±± zö xz 74ezfz zö 4P Äzöö öfl
ck Z Zz öfl/gu z µ Üö±0	
P±ßfluöfl fizΩ zö	75S v± 8ZS
Rzöu flÄz±	7578, Q zΩ F 9 ÄS 375, 9 ÄS v± 97 ÄS 3, H 97 ÄS /497 Nv± 2@7 NO
L öfl	: 5 ö
nz±ä z öfl	
Q öÄ tiö	Zz zö xz nz± ±wµzö z± Qüö Äzö 3Z zö xz S fl µ 4g .h z 3x z Wü 4g .h z öx xz i z µ Üö± z
nz±vz z±wµ	8 v± : 9
L öfl	: 5 ö

## Zffö ö ü-xv ffü xflü- z äz affxväv

c ü üÄü	c üff ± z WüvüM /88>977 vff v± <B Z vff 3Wü zö F877 ö 0 Lf NT/8C977 vff v± 88>977 vff 0 Züxv egh
Ou zöfü ä u	BPB
f uöxu x	La f Tg T. 6 T. 4 < B > 4. 394 ±z

## kz ffi üfi

i z ü fl öfl ffuöö öfl	87 v± : 7 i ONB vz ffuöö öfl 4 öx i z ffü Ü öfl wµ
W± öfl u föupä z	wu59k
ffuöö öfl z±	F7578, 6
fzö ü ffz± öfli f	97 i v± : 7 i

## j ö fizw üfi wzy-üfi üfizü

Mz ±v zä ffz u	497 Nv± 2@7 N
Wflz zä ffz u	4<7 Nv± 2B> N
ezü ±z Üfi fz wµ flÄz±	>, v± C>, vz±7 NBö±wµ Äüöxzö ± zöx

# f Gantner ma R98D hk

R-fir-väz bz öffiy ä

## U ä-firz- yz Öffivvzö

L fi ä z±	LÜä Löfflvzö ßxfl Üflöuvvzßz L fi ä z± üö <> Zß zö
	gzvpmö±vpmz öxz öflzö ü vzmuÜzö

## b zxfivü- xflz Wjff ö v -ffüzü

Zuz ±Ü	LÜä ß±ä öxLMf
Lvä z öflzö/M S g0	: 7 8<> 8: >ä ä
Rz ±vpm	vpm5>77 fl
f vpm ÄÜ z	TC97

## Pz zääjff ö v -ffüzü

L ÄzÜ ä ä z	B7 >@9A
-------------	---------

## Uvü üz W ö zü

O -v Uz övü Tvüxz h zyzü Wyv j hO Qfl-üv h-üfvffffz  
 b ffü vjffüz v zA OSCDE8hxfl ü i 3A@BBBC DDAC@8B  
 d ßv 5hzö wxfl5g-üfi: Cv R5F9: 8Dav |vüyz ezfiü- i 3AF F9: @FFE@ A9

Vertrieb durch

**AMC – Analytik & Messtechnik GmbH Chemnitz**

Heinrich-Lorenz-Str. 55 Tel.: +49/371/38388-0  
 09120 Chemnitz Fax: +49/371/38388-99  
 E-Mail: info@amc-systeme.de Web: www.amc-systeme.de

